

## Kontrol af ultralydtransducere med papirclips.


Indstil skanneren til:

- 1) Én fokuszone og denne skal være så tæt på sålen som muligt.
- 2) Størst mulig forstørrelse.

En lille papirclips evt. med en anelse gele føres langsomt hen over transducersålen.

Den holdes vinkelret på skanneplanet og bevæges langsomt fra den ene ende til den anden.

Bemærk eventuelle udfald på skærmen.

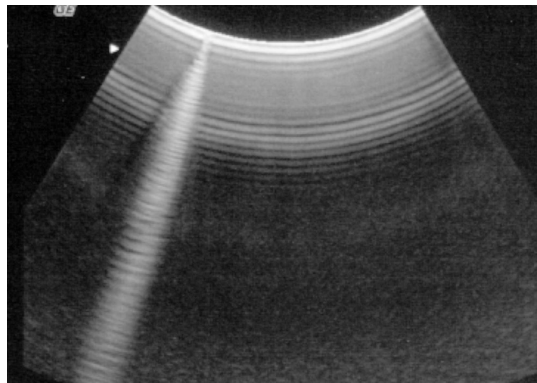

Apparatets identitet:.....

[illegible]